

**УСТРОЙСТВО ПЕНОГАШЕНИЯ
(ПЕНОПОДАВЛЕНИЯ) УПГ-1**


НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для контроля и управления пенообразованием в технологическом процессе ферментации белков (дрожжей и т.п.).

ОПИСАНИЕ

При достижении пеной уровня датчика (2), происходит дозированный впрыск пеногасителя. Повторные впрыски пеногасителя происходят через заданный период времени, если уровень пены превышает установленный.

Устройство пеногашения состоит из устройства управления (1), датчика уровня пены (2), устройства дозирования пеногасителя (3) и емкости с пеногасителем (4).

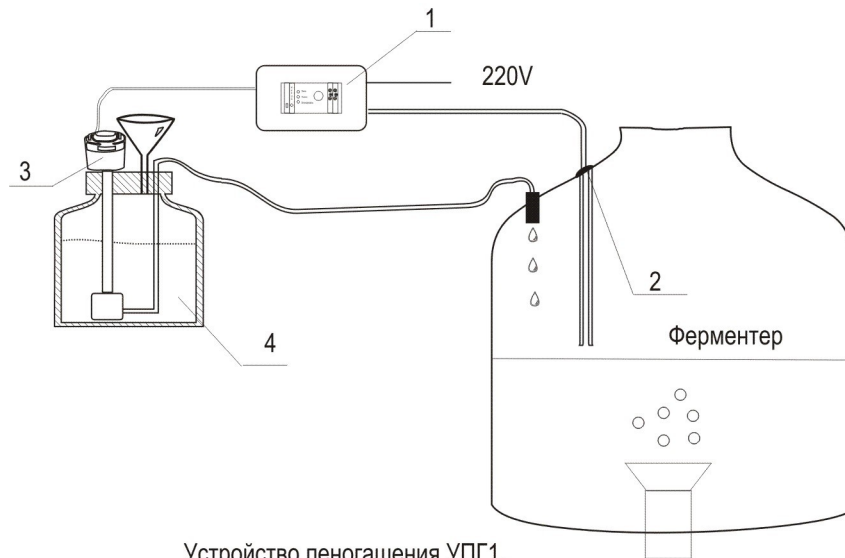

Рабочая жидкость (пеногаситель)	Лапрол-1 и т.п.
Температура пеногасителя, °С,	5 - 50
Время впрыска, С,	0,1 - 60 *
Период подачи дозы пеногасителя, час,	0,1 - 1 *
Температура окружающей среды, °С,	5 - 50
Степень защиты устройства управления	IP40
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Напряжение питания	220 В, 50 Гц

*Положение датчика уровня пены, период подачи дозы пеногасителя и время впрыска (доза) устанавливаются пользователем в зависимости от высоты ферментера и параметров пенообразования.

Украина, 61015, г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61
 тел. (057) 373-33-67;
 тел. моб. +38-066-705-28-2, +38-067-834-57-27;
 E-mail: info@otel.kh.ua;
www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич
 Бильченко Тамара Михайловна